

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижегород (831)429-08-12  
Новокузнецк (3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: [zpb@nt-rt.ru](mailto:zpb@nt-rt.ru) || Сайт: <https://ztpribor.nt-rt.ru>

## ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Манометры ЭкМ, вакуумметры ЭкВ, мановакуумметры ЭкМВ показывающие сигнализирующие

### Назначение средства измерений

Манометры ЭкМ, мановакуумметры ЭкВ, мановакуумметры ЭкМВ показывающие сигнализирующие (в дальнейшем – приборы) предназначены для измерений избыточного и вакуумметрического давления неагрессивных, некристаллизующихся жидкостей, газа, пара и управления внешними электрическими цепями от сигнализирующего устройства прямого действия.

Приборы могут применяться в системах газоснабжения, в энергетике, теплотехнических системах транспортировки различных газов, воды и пара.

### Описание типа средства измерений

В основу работы прибора положен принцип преобразования силы давления через деформацию упругих элементов в механическое перемещение стрелки прибора. Сила давления, действующая на трубчатую пружину, посредством кинематической силы поворачивает стрелку относительно циферблата на соответствующий давлению угол.

Сигнализирующее устройство изготавливают в двух исполнениях: с магнитным поджатием контактов и на базе микровыключателей.

Приборы изготавливаются в стальном корпусе без фланца. Корпус приборов выполнен из стали в виде цилиндра диаметром 100 мм, 160 мм и может быть заполнен силиконом.

Общий вид приборов представлен на рисунках 1-2.

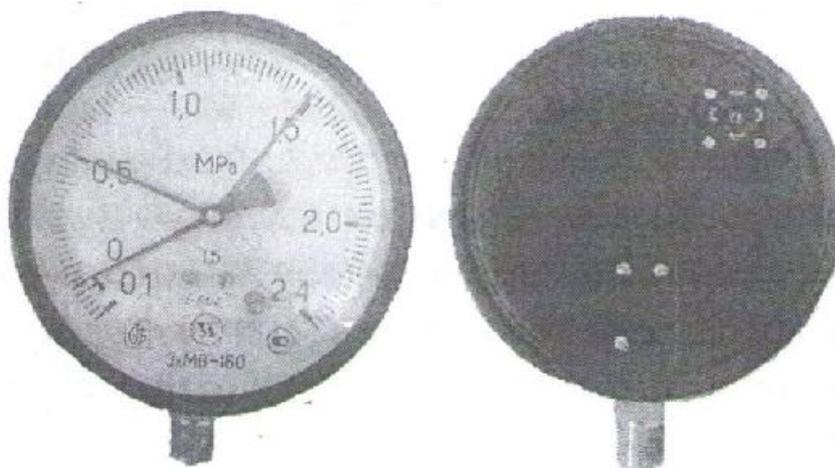


Рисунок 1 – Общий вид приборов

Место нанесения знака поверки (клейма-наклейки)



Рисунок 2 – Место нанесения знака поверки

**Программное обеспечение**  
отсутствует.

**Метрологические и технические характеристики**  
приборов приведены в таблицах 1-2.

Таблица 1 - Метрологические характеристики

Наименование прибора	Обозначение прибора	Диапазон показаний, МПа	Класс точности по ГОСТ 2405-88
Манометр сигнализирующий показывающий (с диаметром корпуса 160, 100 мм)	ЭкМ-160 ЭкМ-160Вм ЭкМ-160НВм ЭкМ-100 ЭкМ-100Вм ЭкМ-100НВм	от 0 до 0,1 от 0 до 0,16 от 0 до 0,25 от 0 до 0,4 от 0 до 0,6 от 0 до 1,0	1,5 2,5
	ЭкМ-160НВм-Ву ЭкМ-100НВм-Ву	от 0 до 1,6 от 0 до 2,5 от 0 до 4,0 от 0 до 6,0 от 0 до 10,0 от 0 до 16,0 от 0 до 25,0	
Вакуумметр сигнализирующий показывающий (с диаметром корпуса 160 мм)	ЭкВ-160 ЭкВ-160Вм ЭкВ-160НВм	от -0,1 до 0	1,5 2,5
Мановакуумметр показывающий сигнализирующий (с диаметром корпуса 160, 100 мм)	ЭкВМ-160 ЭкВМ-160Вм ЭкВМ-160НВм ЭкВМ-100 ЭкВМ-100Вм ЭкВМ-100НВм	от -0,1 до + 0,15 от -0,1 до + 0,3 от -0,1 до + 0,5 от -0,1 до + 0,9 от -0,1 до + 1,5 от -0,1 до + 2,4	

Наименование прибора	Обозначение прибора	Диапазон показаний, МПа	Класс точности по ГОСТ 2405-88
Мановакуумметр показывающий сигнализирующий с жидкостным наполнением (с диаметром корпуса 160, 100 мм)	ЭкВМ-160НВм-Бу ЭкВМ-100НВм-Бу		
<p>Примечания:</p> <p>1) Измеряемая среда – газ, пар, жидкость (в том числе ацетилен)</p> <p>2) Диапазоны измерений избыточных давлений от 25 % до 75 % диапазона показаний;</p> <p>3) Диапазоны измерений вакуумметрического давлений равны диапазонам показаний.</p> <p>4) Пределы допускаемой основной погрешности приборов, выраженные в процентах от диапазона показаний: <math>\pm 1,5</math>; <math>\pm 2,5</math> % для классов точности 1,5 и 2,5 по ГОСТ 2405-88 соответственно.</p> <p>5) Вариация показаний приборов не более абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности приборов.</p> <p>6) Число срабатываний сигнализирующего устройства прибора, не менее 200000.</p> <p>7) Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства и пределы допускаемой погрешности измерений после срабатывания сигнализирующего устройства (за пределами диапазона установок), выраженные в процентах от диапазона показаний: <math>\pm 6</math> % - для приборов с магнитным поджатием контактов сигнализирующего устройства; <math>\pm 4</math> % - для приборов, сигнализирующее устройство которых выполнено на базе микровыключателей.</p> <p>8) Вариация срабатывания сигнализирующего устройства приборов не более абсолютного значения предела допускаемой основной погрешности срабатывания сигнализирующего устройства.</p>			

Таблица 2 - Технические характеристики

Наименование характеристики	Значение	
Масса приборов, кг, не более	ЭкМ-100 ЭкМВ-100 ЭкМ-100Вм ЭкМВ-100Вм ЭкМ-100НВм ЭкМВ-100Вм	0,7
	ЭкМ-100НВм-Бу ЭкМ-100НВм-Бу	0,9
	ЭкМ-160Вм ЭкВ-160Вм ЭкМВ-160Вм ЭкМ-160НВм ЭкВ-160НВм ЭкМВ-160НВм	1,2
	ЭкМ-160НВм-Бу ЭкМВ-160НВм-Бу	1,8
	ЭкМ-160 ЭкВ-160 ЭкМВ-160	1,6

Наименование характеристики	Значение	
Габаритные размеры, диаметр, мм, не более	ЭкМ-100 ЭкМВ-100 ЭкМ-100Вм ЭкМВ-100Вм ЭкМ-100НВм ЭкМВ-100Вм ЭкМ-100НВм-Бу ЭкМ-100НВм-Бу	100
	ЭкМ-160Вм ЭкВ-160Вм ЭкМВ-160Вм ЭкМ-160НВм ЭкВ-160НВм ЭкМВ-160НВм ЭкМ-160НВм-Бу ЭкМВ-160НВм-Бу ЭкМ-160 ЭкВ-160 ЭкМВ-160	160
Напряжение внешних коммутируемых цепей для приборов с магнитным поджатием контактов <sup>1)</sup> , В	Для цепей переменного тока с частотой (50±1) Гц	24; 27; 40; 110; 230; 380
	Для цепей постоянного тока	24; 27; 40; 60; 110; 230
Напряжение внешних коммутируемых цепей для приборов с сигнализирующим устройством, выполненных на базе микровыключателей <sup>1)</sup> , В	Для цепей переменного тока с частотой (50±1) Гц	110; 230
	Для цепей постоянного тока	24; 230
Степень защиты оболочки в соответствии с ГОСТ 14254-2015	IP40; IP54	

### Знак утверждения типа

наносится методом штемпельной печати в паспорт прибора, а также на циферблат или корпус прибора.

### Комплектность средств измерений

Комплектность приборов соответствует указанной в таблице 3.

Таблица 3 - Комплектность средств измерений

Наименование	Обозначение	Количество	Примечание
Прибор	ЭкМ-100 ЭкМВ-100 ЭкМ-100Вм ЭкМВ-100Вм ЭкМ-100НВм ЭкМВ-100Вм ЭкМ-100НВм-Ву ЭкМ-100НВм-Ву ЭкМ-160Вм ЭкВ-160Вм ЭкМВ-160Вм ЭкМ-160НВм ЭкВ-160НВм ЭкМВ-160НВм ЭкМ-160НВм-Ву ЭкМВ-160НВм-Ву ЭкМ-160 ЭкВ-160 ЭкМВ-160	1 шт.	
Паспорт	ФИУШ.406121.024ПС	1 экз.	
РЭ	ФИУШ.406121.024РЭ	1 экз.	По требованию заказчика
Упаковка		1 шт.	

### Поверка

осуществляется по документу МИ 2124-90 «Рекомендация. ГСИ. Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры показывающие и самопишущие. Методика поверки».

Основные средства поверки:

Манометры избыточного давления грузопоршневые МП-2,5; МП-6; МП-60; МП-250 (Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде 58794-14)

Мановакуумметр грузопоршневой МВП-2,5 (Регистрационный номер в Федеральном информационном фонде № 1652-99).

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемого средства измерений с требуемой точностью.

Знак поверки наносится в паспорт и (или) на свидетельство о поверке и(или) на корпус прибора.

### Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

### Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к манометрам, вакуумметрам, мановакуумметрам, напоромерам и тягонапоромерам показывающим

ГОСТ 2405-88 Манометры, вакуумметры, мановакуумметры, напоромеры, тягомеры и тягонапоромеры. Общие технические условия

ТУ РБ 37388602.001-96 Манометры МП, вакуумметры ВП, мановакуумметры МВП, напоромеры НП, тягомеры ТП, тягонапоромеры ТНП показывающие. Технические условия

## По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (7273)495-231  
Ангарск (3955)60-70-56  
Архангельск (8182)63-90-72  
Астрахань (8512)99-46-04  
Барнаул (3852)73-04-60  
Белгород (4722)40-23-64  
Благовещенск (4162)22-76-07  
Брянск (4832)59-03-52  
Владивосток (423)249-28-31  
Владикавказ (8672)28-90-48  
Владимир (4922)49-43-18  
Волгоград (844)278-03-48  
Вологда (8172)26-41-59  
Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89  
Иваново (4932)77-34-06  
Ижевск (3412)26-03-58  
Иркутск (395)279-98-46  
Казань (843)206-01-48

Калининград (4012)72-03-81  
Калуга (4842)92-23-67  
Кемерово (3842)65-04-62  
Киров (8332)68-02-04  
Коломна (4966)23-41-49  
Кострома (4942)77-07-48  
Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61  
Курск (4712)77-13-04  
Курган (3522)50-90-47  
Липецк (4742)52-20-81  
Магнитогорск (3519)55-03-13  
Москва (495)268-04-70  
Мурманск (8152)59-64-93  
Набережные Челны (8552)20-53-41  
Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новокузнецк(3843)20-46-81  
Ноябрьск (3496)41-32-12  
Новосибирск (383)227-86-73

Омск (3812)21-46-40  
Орел (4862)44-53-42  
Оренбург (3532)37-68-04  
Пенза (8412)22-31-16  
Петрозаводск (8142)55-98-37  
Псков (8112)59-10-37  
Пермь (342)205-81-47  
Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Рязань (4912)46-61-64  
Самара (846)206-03-16  
Саранск (8342)22-96-24  
Санкт-Петербург (812)309-46-40  
Саратов (845)249-38-78  
Севастополь (8692)22-31-93  
Симферополь (3652)67-13-56  
Смоленск (4812)29-41-54  
Сочи (862)225-72-31  
Ставрополь (8652)20-65-13  
Сургут (3462)77-98-35

Сыктывкар (8212)25-95-17  
Тамбов (4752)50-40-97  
Тверь (4822)63-31-35  
Тольятти (8482)63-91-07  
Томск (3822)98-41-53  
Тула (4872)33-79-87  
Тюмень (3452)66-21-18  
Ульяновск (8422)24-23-59  
Улан-Удэ (3012)59-97-51  
Уфа (347)229-48-12  
Хабаровск (4212)92-98-04  
Чебоксары (8352)28-53-07  
Челябинск (351)202-03-61  
Череповец (8202)49-02-64  
Чита (3022)38-34-83  
Якутск (4112)23-90-97  
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

Эл. почта: [zpb@nt-rt.ru](mailto:zpb@nt-rt.ru) || Сайт: <https://ztpribor.nt-rt.ru>